



DESCRIZIONE

Dimensioni: 200 mm

Finitura: satinata opaca


STRUMENTO CHIRURGICO RIUSABILE

Dispositivo medico di Classe I conforme ai Requisiti Essenziali ed alle prescrizioni della Direttiva 93/42 CEE e 2007/47EC.

Assoggettato alle procedure stabilite nell'Allegato VII della Direttiva 93/42 CEE.

Soddisfa i requisiti della norma UNI CEI EN ISO 14971.

Uso previsto: Lo Strumento utilizzato per scopi di taglio deve essere utilizzato secondo protocolli chirurgici prestabiliti dalla struttura presso cui entrerà in servizio ed adoperato da personale opportunamente addestrato nella pratica medica.

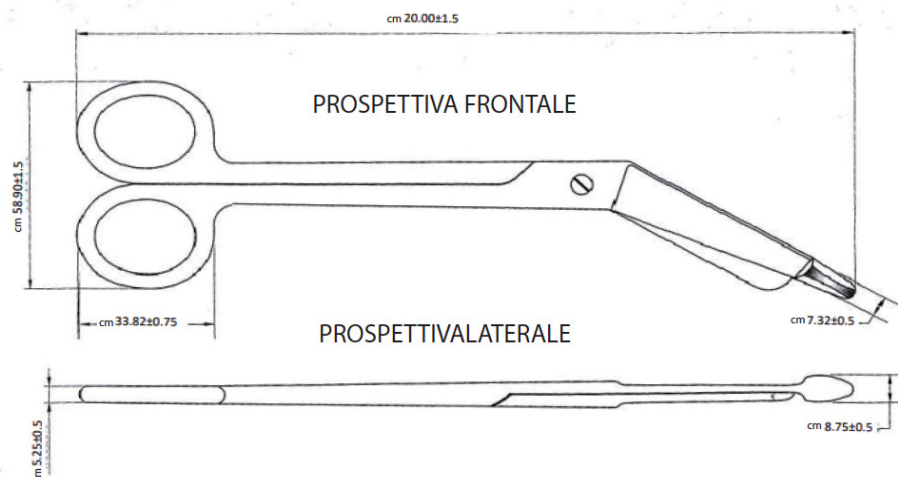

Sterilizzabile in autoclave fino alla temperatura di 134°C previo lavaggio, risciacquo ed asciugatura, come da indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso, dalla pratica medica e dai protocolli clinici della struttura clinica dove verrà impiegato lo strumento.